



## Hygiene-Kühlschrank 700 l mit geprägten Sicken


Artikel-Nr.  
90621055 (700NT)



---

### Explosionszeichnung / Ersatzteilliste

---

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und  
Seriennummer mit angeben!

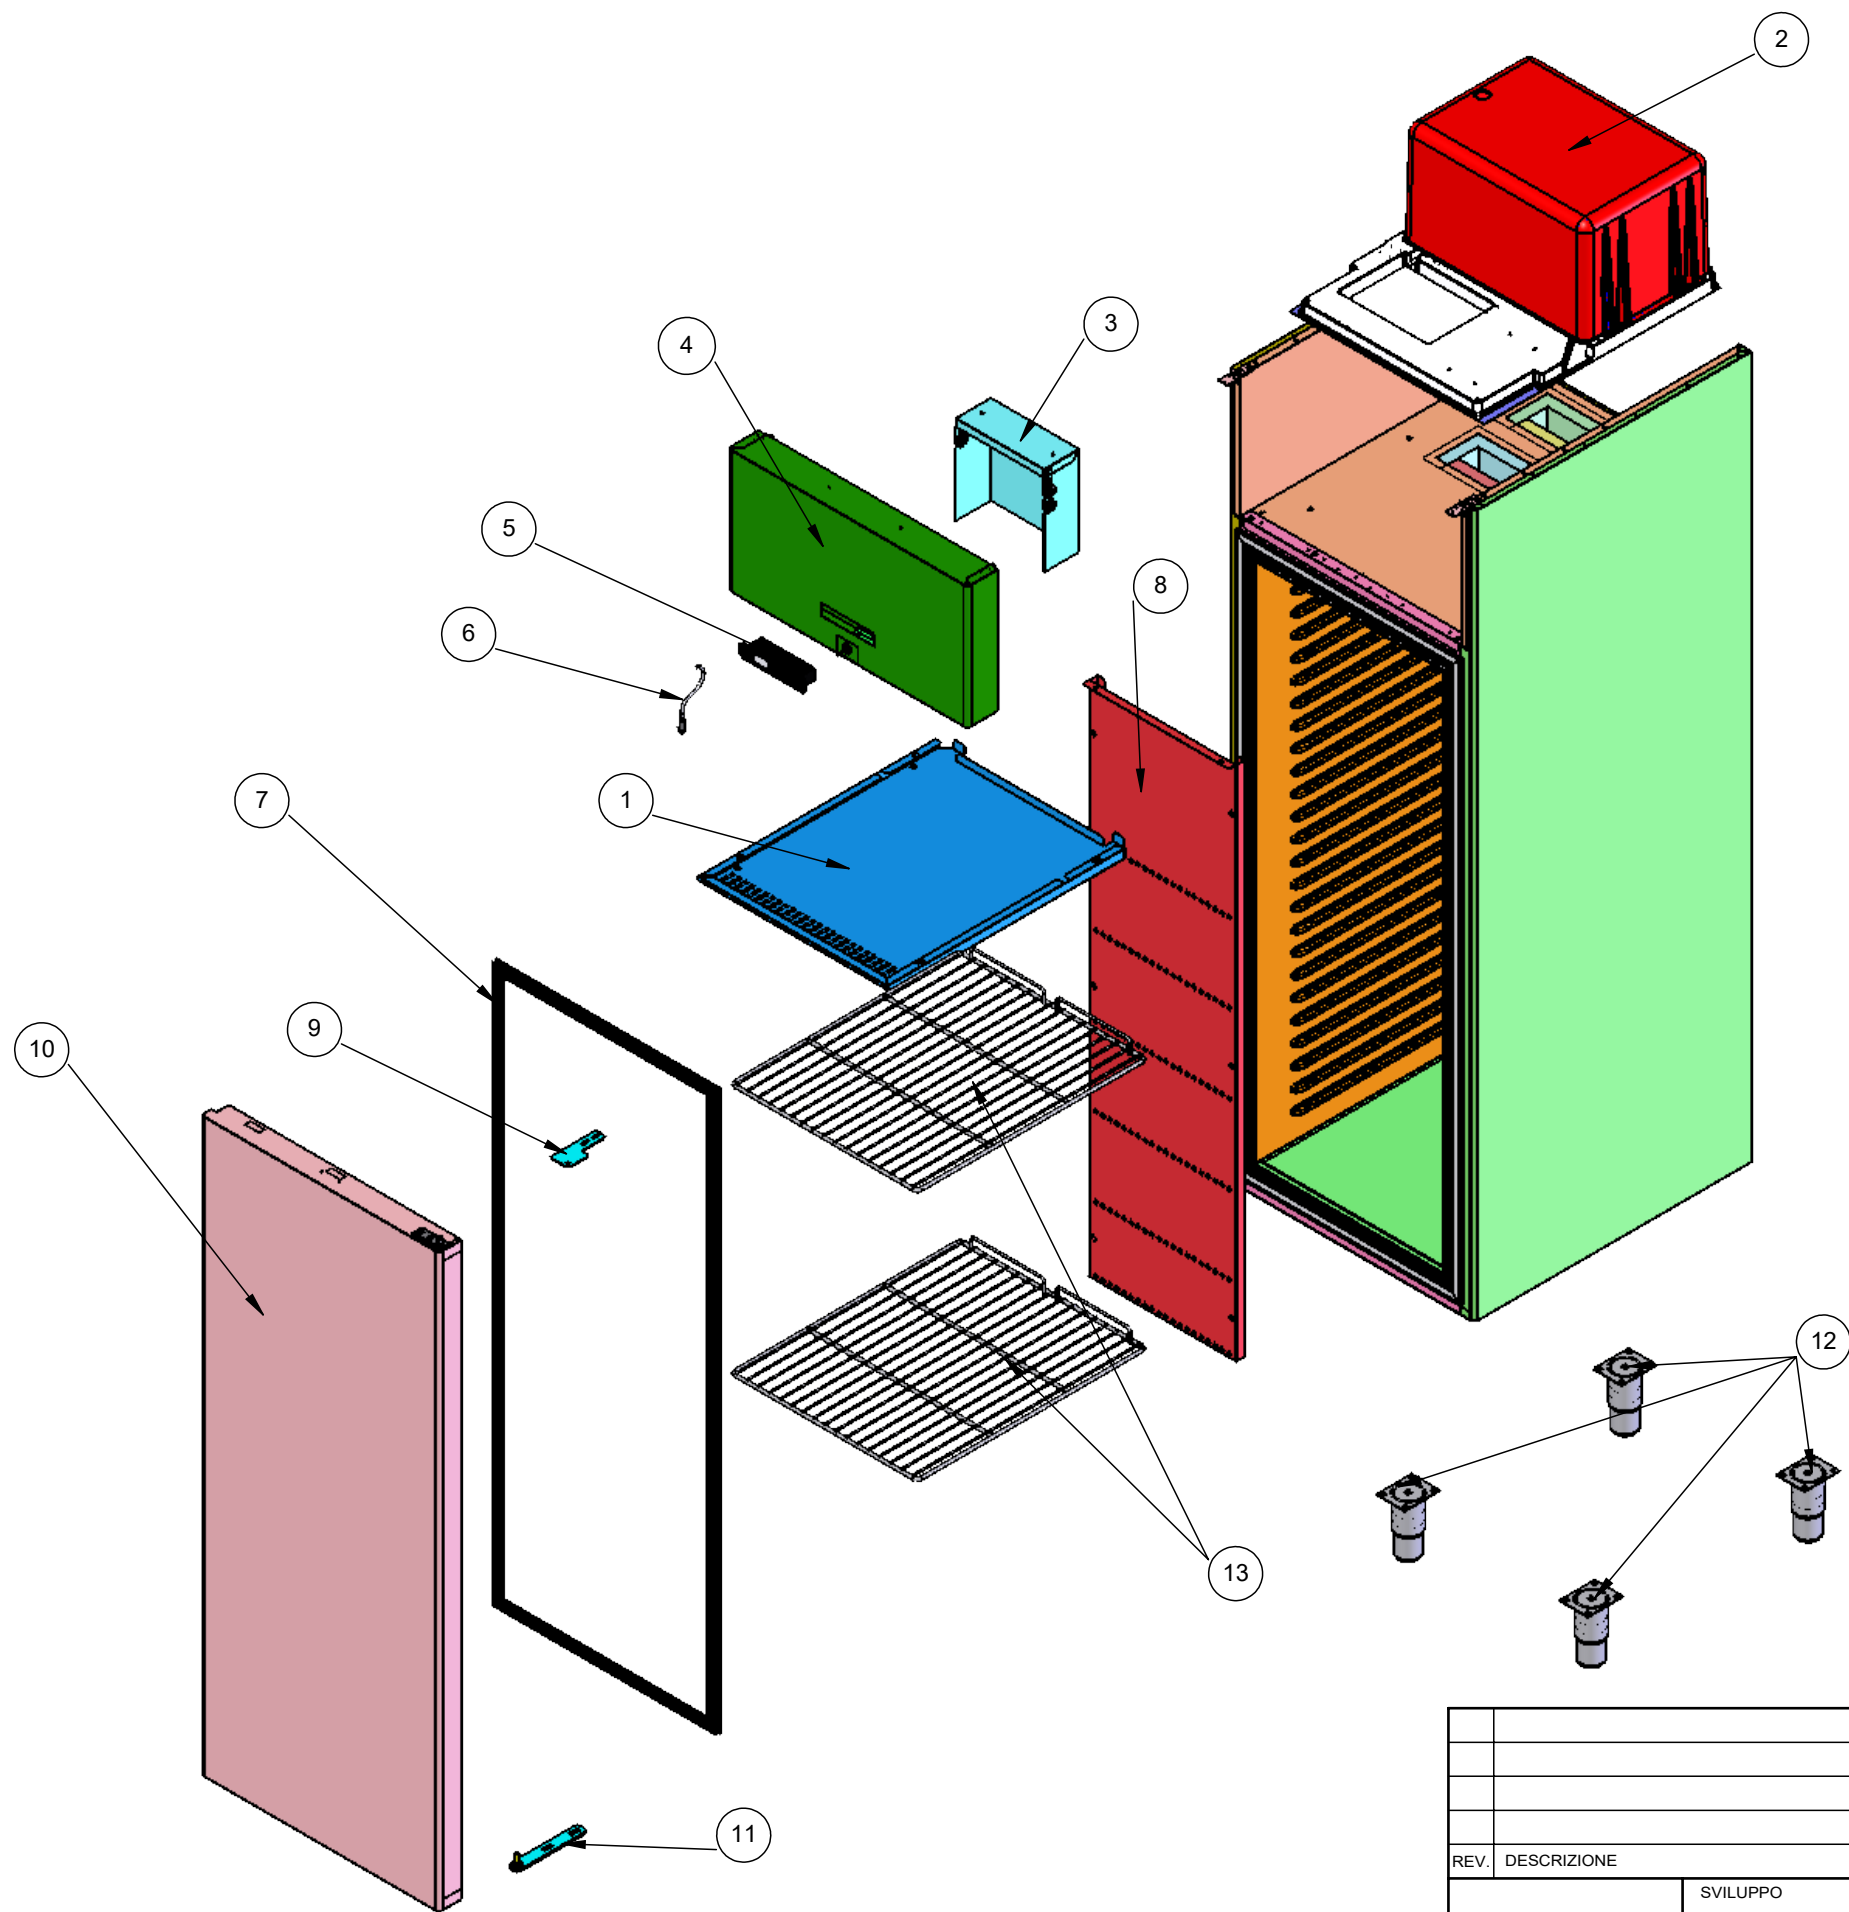

				AS	SC	MS	ES	TG	CQ	FN	-	-
				MATERIALE								
				STATO								
REV.	DESCRIZIONE	DATA	FIRMA	QUESTO DISEGNO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE								
		SVILUPPO	SCALA 1:15	TOLLERANZE GENERALI		FIRMA		DATA				
MODELLO				LAMIERA	PROFILO	G. Bonsembiante		23-mag-17				
				L<500 ±0.5	± 0.5	APPROVATO						
				L>500 ±1	L= 0++30							
				ANGOLI ±30'	SP= ±10%							
DESCRIZIONE								CODICE				
<b>ARM.700 LT BLOCK RIVACOLD -2/+8 1PDX IGIENE TN</b>								<b>KKD8000-H01 - ESPLOSO</b>				
A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA												

**TABELLA ELENCO COMPONENTI ESPLOSI – KKD8000\*H01**

Articolo Numero	NOME DEL FILE	OGGETTO
1	KZ2R000*000	ASS.LAM.CANALIZZ.ASPIRAZ.ARIA ARM. 700 LT IGIENE
2	UNSEM007PE01	UNITA'BLOCKSYSTEM 700lt -2 +8°C R290 GAS CALDO
3	KZ38001*000	SCATOLA COPERTURA ELETTRONICA ARM.
4	KZ2G000*130S	CRUSCOTTO R10 SP. 88 ARM. IGIENE KKD8 DIXELL+S
5	UNEL*071	TELETERM. XW60LRH-5N1C0D NTC 2R=5+8+20+BUZ 230V
6	SG00S003	MAGNETIC SENSOR D1021BDAP080 CAVO L=800
7	SG00G488G	GUARNIZ. 036 0609X1545 TRIPOLARE
8	KZ2S000*000	CANAL.MAND.ARIA ARM. 700 LT IGIENE S/DEFLETT.
9	KZ58001*000	STAFFA SUPERIORE CERNIERA L=130
10	KNF3000*000DX	ASS.PORTA 1/1 SP. 80 R10 P.ROV. ARM. IGIENE DX
11	KZ37000*000	STAFFA INF.CERNIERA UNICUM/DIAMOND
12	CGPI*124	ASS.PIEDE 2" REG.115-170mm PIASTRA FORI 60X80
13	CGGR*013	GRIGLIA FRIGO 530x650 PLAST. GRP161 CON FERMO

**TABELLA ELENCO COMPONENTI ESPLOSI – KKD8000\*L01**

Articolo Numero	NOME DEL FILE	OGGETTO
1	KZ2R000*000	ASS.LAM.CANALIZZ.ASPIRAZ.ARIA ARM. 700 LT IGIENE
2	UNSEL007PE01	UNITA'BLOCKSYSTEM 700lt -20°C R290 GAS CALDO
3	KZ38001*000	SCATOLA COPERTURA ELETTRONICA ARM.
4	KZ2G000*130S	CRUSCOTTO R10 SP. 88 ARM. IGIENE KKD8 DIXELL+S
5	UNEL*071	TELETERM. XW60LRH-5N1C0D NTC 2R=5+8+20+BUZ 230V
6	SG00S003	MAGNETIC SENSOR D1021BDAP080 CAVO L=800
7	SG00G488G	GUARNIZ. 036 0609X1545 TRIPOLARE
8	KZ2S000*000	CANAL.MAND.ARIA ARM. 700 LT IGIENE S/DEFLETT.
9	KZ58001*000	STAFFA SUPERIORE CERNIERA L=130
10	KNF3000*000DX	ASS.PORTA 1/1 SP. 80 R10 P.ROV. ARM. IGIENE DX
11	KZ37000*000	STAFFA INF.CERNIERA UNICUM/DIAMOND
12	CGPI*124	ASS.PIEDE 2" REG.115-170mm PIASTRA FORI 60X80
13	CGGR*013	GRIGLIA FRIGO 530x650 PLAST. GRP161 CON FERMO